

VšĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA
Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas
Telefonas (8-37) 40 39 99
Faksas (8 37) 45 15 75
info@kaunopoliklinika.lt
www.kaunopoliklinika.lt

Įmonės kodas 135042394
PVM mokėtojo kodas LT 350423917
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A. S. LT047044060002942424
Direktorius Paulius Kibiša



Rinkos dalyviams

DĖL IŠANKSTINĖS (RINKOS) KONSULTACIJOS DĖL LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ LAIKYMO - DŽIOVINIMO SPINTOS PIRKIMO

VšĮ Kauno miesto poliklinika (toliau - Perkančioji organizacija), vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymo) 27 str., siekdama pasirengti Lanksčių endoskopų laikymo - džiovinimo spintos pirkimui, vykdė išankstinę (rinkos) konsultaciją (CVP IS ID 3227070).

Perkančioji organizacija, atsižvelgusi ir įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautus Dalyvių klausimus ir pasiūlymus, teikia atsakymus:

| Paklausimai/ pastabos (tekstas neredaguotas) | | | Atsakymas |
|---|--------------------------|---|---|
| 3. Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjo manymu, yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami? <i>Taip, yra sunkiai įgyvendinamų parametrų. Mūsų siūlomos spintos matmenys: plotis 130cm, aukštis 207cm, gylis 45 cm. Todėl nors ir siūlome geresnių ir patogesnių naudojimui išmatavimų spintą, tačiau negalėtume dalyvauti pirkime pagal paskelbtą techninę specifikaciją. Siūlome koreguoti techninės specifikacijos 5 punktą į Plotis ≤ 135 cm, Aukštis ≤ 220 cm, Gylis ≤ 70 cm</i> | | | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus. |
| 7. Kokią kainodarą ir apmokėjimo už prekes tvarką rekomenduotumėte taikyti? <i>Apmokėjimas pristačius ir sumontavus perkamą įrangą</i> | | | Perkančioji organizacija, atsižvelgs į gautą dalyvio pasiūlymą ir patikslins Techninėje specifikacijoje suformuluotą reikalavimą. |
| <i>Lanksčių endoskopų džiovinimo ir laikymo dvipusė spinta, kurios paskirtis - džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus.</i> | <i>Būtina</i> | <i>Dvipusė spinta tai sprendimas pasirinktas vieno gamintojo. Jis užkerta kelią daryti pasiūlymus kitus analogiškas charakteristikas turinčius gaminius</i> | Perkančioji organizacija, atlikusi rinkos tyrimą, randa daugiau nei tris gamintojus, siūlančius tokią įrangą (Lanksčių endoskopų džiovinimo ir laikymo dvipusė spinta), todėl nemano, jog nustatytas reikalavimas yra ribojantis konkurenciją ar užkertantis dalyvauti pirkime daugiau nei vienam tiekėjui. |
| <i>Montavimas</i> | <i>Spinta montuojama</i> | <i>Kriterijus netikslus ir klaidinantis,</i> | Spinta bus montuojama jau esamoje sienos angoje. Ji, kaip ir nurodyta, turi atsiderinėti iš abiejų pusių. Perkančioji organizacija šį |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>sienoje. Spintos durelių atidarymas, uždarymas abiejuose spintos pusėse.</p> | <p>Esant šiam kriterijui turi būti numatyti ir statybos remonto darbai(sienos griovimo ir perstatymo darnai su apdaila ir tt.) Visai nėra aišku, ar spinta turi jungtis prie įstaigos stacionarių komunikacijų (pavyzdžiui ventiliacijos sistemos ir t.t.)</p> | <p>reikalavimą suformulavo pagal savo poreikius. Dalyvio nurodyti darbai nereikalingi ir Perkančioji organizacija nėra numačiusi jų atlikimo. Kadangi dalyvis nenurodė, kaip tiksliai siūlytų suformuluoti minėtą reikalavimą, Perkančioji organizacija spres dėl poreikio jį tikslinti.</p> |
| <p>Džiovinamų laikomų endoskopų skaičius</p> | <p>Ne mažiau 8 endoskopai</p> | <p>Perkant įrenginį perkančiajai organizacijai naudinga pasilikti sau galimybę ateityje toje pačioje spintoje galėti talpinti didesnę skaičių endoskopų .pavyzdžiui dar 2 vnt</p> | <p>Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja, nurodydama, jog šiuo metu jos poreikiams patenkinti pakankamas skaičius yra 8 vnt.).</p> |
| <p>Jungčių rinkinys saugojamiems endoskopams (jei jungiasi ne tiesiogiai). Tinkantys endoskopų modeliams CF-H185L, GIF-H185, gamintojas Olympus</p> | <p>Ne mažiau 8</p> | <p>Siūlomas parametras yra naudingas tikrai konkretaus gaminio pardavėjui,. Pirkėjui atvirksčiai nenaudingas, nes riboja jo paslaugų plėtrą ateityje pririšdamas prie konkreto gamintojo konkrečių gaminių modelių. Tai tiesiogiai pririša perkančiąją organizaciją prie vieno gamintojo gaminamų endoskopų ir kertasi su Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais. Tuo pačiu perkančiajai organizacijai</p> | <p>Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. Perkančioji organizacija turi įsigijusi konkrečius nurodytus endoskopus, todėl Techninėje specifikacijoje nurodė, kokios jungtys šiuo metu yra reikalingos.</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | naudinga kad perkamoje spintoje galima būtų džiovinti ir saugoti ne tiktai gastroskopus kaip nurodyta, bet ir kolonoskopus ir pagal poreikį ne tiktai vieno gamintojo, šiuo atveju Olympus. | |
| Endoskopų laikymo - džiovinimo spintos matmenys. | Plotis 135 ±5 cm Aukštis 220 ±5cm Gylis 70 ±5 cm | Siūlomas parametras yra atitinkantis konkretų gaminį (DRS-218 gaminama MDG MEDICAL DEVICES GROUP) ir eliminuoja kitų gamintojų gaminius. | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus. |
| Reikalavimas durims | Durys abiejuose laikymo spintos pusėse, automatinis užraktas | Čia galima sutikti tiktai su reikalavimu , kad turi būti automatinis užraktas, šio kriterijaus sujungimas su reikalavimu kad būtų durys abiejose spintos pusėse yra sąmoningas vieno gamintojo gaminio protegavimas eliminuojant konkurentus. | Perkančioji organizaciją, atlikusi rinkos tyrimą, randa daugiau nei tris gamintojus, siūlančius tokią įrangą (Durys abiejose laikymo spintos pusėse, automatinis užraktas), todėl nemano, jog nustatytas reikalavimas yra ribojantis konkurenciją ar užkertantis dalyvauti pirkime daugiau nei vienam tiekėjui. |
| Integruotas suspausto oro kompresorius endoskopų laikymo spintoje | Būtina | Siūlomas parametras yra svarbus ir tokia jo traktuotė nenurodant kokybinių kriterijų (šiuo atveju svarbu yra kompresoriaus tipas - svarbu, kad būtų be alyvos)yra naudinga tik pardavėjui, bet pirkėjui gali kelti techninių problemų | Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo pastebėjimą, spres dėl minėto parametro reikalingumo ir/arba tikslinimo. |
| Įrenginio veikimas | Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis | Siūlomas parametras yra svarbus ir tokia jo traktuotė nenurodant kokybinių kriterijų , (šiuo atveju - optimalus viršslėgis) yra naudinga tik pardavėjui, bet | Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. |


| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <i>pirkėjui gali kelti techninių problemų</i> | |
| <i>Oro srauto ciklai</i> | <i>Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje ir išorėje</i> | <i>Siūlomas parametras yra svarbus ir tokia jo traktuotė nenurodant kokybinių kriterijų yra naudinga tik pardavėjui, bet pirkėjui gali kelti techninių problemų</i> | Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. |
| <i>Vidinių kanalų džiovinamas</i> | <i>Suspaustu sausu medicininiu arba filtruotu aplinkos oru</i> | <i>Siūlomas parametras yra svarbus ir tokia jo traktuotė nenurodant kokybinių kriterijų yra naudinga tik pardavėjui, bet pirkėjui gali kelti techninių problemų</i> | Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. |
| <i>Oro filtravimas</i> | <i>HEPA 13 filtras arba aukštesnės kokybės</i> | <i>Siūlomas parametras yra svarbus ir tokia jo traktuotė nenurodant kokybinių kriterijų yra naudinga tik pardavėjui, bet pirkėjui gali kelti techninių problemų</i> | Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. |
| <i>Informacijos dokumentavimas ir vaizdavimas endoskopų laikymo spintos ekrane</i> | <i>1. Vartotojo ID; 2. Endoskopo sausinimo ir laikymo laikas; 3. Endoskopo modelis; 4. Endoskopo sausinimo statusas; 5. Klaida</i> | <i>Siūlomas parametras numato spintos atitikimo būtinumą EN16442-2015 arba lygiaverčiam standartui. Tai norma taikoma prietaisams su elektroniniu pastoviu veikimo monitoringu. Perkančioji organizacija turi sąmoningai pasirinkti šių parametru būvimą, įvertindama tai, kad jie padidina perkamo gaminio kainą 30%, gaminio eksploatacinės sąnaudų ženkliai didėja (</i> | Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. Perkančioji organizacija perka aukštesnės klasės endoskopų džiovinimo spintą, todėl šiuo atveju atitikimas teisės aktų reikalavimams yra labai svarbus ir būtinas. |

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| | | <p>programinės įrangos valdymo kaštai, gedimų didesnė tikimybę, papildomų paslaugų pirkimo sąnaudos ir tt) . Konkurso reikalavimuose tai nėra apspręsta ir į kainą neįskaičiuota-perkančioji organizacija turės skelbti naują Viešą pirkimą šioms paslaugoms pirkti.</p> | |
| Endoskopų džiovinimo laikas spintoje | ≤ 120 minučių | <p>Siūlomas parametras nėra korektiškas ir vertingas praktinė prasme. Endoskopų džiovinimo laikas spintoje priklauso ne tik nuo spintos įrangos savybių, bet ir nuo į ją džiovinimui ir saugojimui patalpintų fibroskopų drėgnumo ,tai yra jis tiesiogiai įpareigoja spintos pirkėją pirkti atitinkamą sterilizavimo įrenginį .</p> | <p>Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. Perkančioji organizacija neginčija, jog Endoskopų džiovinimo laikas spintoje priklauso ne tik nuo spintos įrangos savybių, bet ir nuo į ją džiovinimui ir saugojimui patalpintų prietaisų, tačiau pažymi, jog nustačius konkretų džiovinimo laiką, galima įvertinti, koks kompresorius ir oro srauto greitis džiovinimui yra reikalingas.</p> |
| Endoskopų laikymo spintoje terminas po kurio nereikalinga aukšto lygio dezinfekcija | ≥ 28 paros | <p>Parametras netikslus, neaiškus ir klaidinantis. Iš reikalavimo reikia suprasti, kad po ≥ 28 parų darbo „Endoskopų laikymo spintoje reikalinga aukšto lygio dezinfekcija“ kas, greičiausia, nėra teisingas vertimas, gamintojas siekė kitos prasmės. Tokiems įrenginiams kaip endoskopų laikymo ir džiovinimo spinta yra taikomas kriterijus nurodantis kiek laiko joje laikomi ir džiovinami endoskopai po dezinfekcijos išlieka tokio švarumo lygio,</p> | <p>Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo pastebėjimą, spęs dėl minėto parametro reikalingumo ir/arba tikslinimo.</p> |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| | | <p>kaip to reikalauja jų darbui keliami saugumo reikalavimų kriterijai. Šie terminai gamintojų pateikiami dviejų reikšmių, atsižvelgiant į praktines spintos darbo aplinkybes.</p> <p>Pirmas kriterijus - laikas kai spintoje esantys fibroskopai yra darbui naudojami pastoviai - vieni išimami, kiti įdedami, tai yra spintos durys atidaromos dažnai, tai daro keli asmenys, spintos aplinkos oro užterštumas yra standartinis, kitų aplinkos veiksnių poveikis patalpoje yra normos ribose. Paprastai jis turi būti ne mažiau 72 valandų. Įstaigose kuriose teikiamos pastovios paslaugos naudojant fibroskopus, ilgesnio kriterijaus nereikia.</p> | |
| Atsekamumo tipas | Atspausdintas kvitas, kuriame nurodoma: | Tos pačios pastabos kaip ir punktui Nr. 12. | Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. |
| Identifikacija | Barkodas arba RFID skaitiklis arba lygiavertis sprendimas | Tos pačios pastabos kaip ir punktui Nr. 12. | Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. |
| Integruotas spausdintuvas | Būtina | Tos pačios pastabos kaip ir punktui Nr. 12. | Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. |
| Spausdinimo popieriaus matmenys | 78x71 mm ± 2 mm | Reikalavimas nekorektiškas, nepagrįstas perkančiosios organizacijos būtiniais poreikiais ir tiesiogiai siejamas su konkrečiu gaminiu tuo | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus. |

| | | <i>eliminuojamas alternatyvus pasiūlymus.</i> | |
|-----------------------|--|---|--|
| <i>Komplektacija*</i> | <ol style="list-style-type: none"><i>1. Visos reikalingos priemonės ir priedai nurodyti pagal gamintoją.</i><i>2. Priedai reikalingi įstaigoje turimiems lankstiams endoskopams prijungti.</i><i>3. Spausdinimo popierius ≥ 5 vnt.</i> | <i>Parametras beprasmis ir nekonkretus, išskyrus reikalavimą, kad turi būti ne mažiau 5 vnt. spausdinimo popieriaus, bet ir čia neaiškų ar tai popieriaus lapų ar kažkokioje kitame pavidale prašomo spausdinimo popieriaus kiekis.</i> | <i>Perkančioji organizacija kelia reikalavimus, kurie jai svarbūs ir reikalingi, atsižvelgdama į savo poreikius, todėl minėto reikalavimo keisti neplanuoja. Visa komplektacija turi būti sumontuota taip kaip nurodyta gamintojo ir pardavėjas negali daryti jokių pakeitimų.</i> |

Dėkojame už dalyvavimą, pateiktas pastabas bei pasiūlymus.

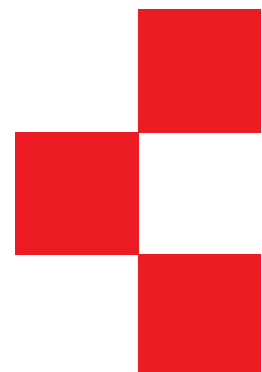

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Aurelija Družinienė |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Atsakymai į rinkos konsultaciją |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2025-08-01 Nr. S (E)-1429 |
| Adresatas | Kiti |
| Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data | Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Viešųjų pirkimų specialistas Aurelija Družinienė 2025-08-01; Vizavimas: Viešųjų pirkimų skyrius-Viešųjų pirkimų specialistas Aurelija Družinienė 2025-08-01 |
| Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius | 0 |
| Papildomi metaduomenys | Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“. |
